

**PROCEDURA SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
MATERIALE TECNICO FUNZIONALE ALLA RACCOLTA DEI CAMPIONI BIOLOGICI (URINE E/O SANGUE)**

Verbale della terza seduta pubblica

Il giorno 4 Febbraio 2021, alle ore 10.00, in Roma, presso gli Uffici della Federazione Medico Sportiva Italiana di Viale Tiziano nr. 70, innanzi alla Commissione di gara, hanno luogo in seduta pubblica le operazioni successive alla conclusione della fase istruttoria sulla documentazione amministrativa e, segnatamente, le operazioni di valutazione delle offerte tecniche presentate dalle Ditte ammesse per l'affidamento della fornitura di materiale tecnico (kit antidoping e bicchieri di raccolta) funzionale alla raccolta dei campioni biologici urinari ed ematici prelevati a cura degli Ispettori DCO/BCO FMSI a fini antidoping, di cui al Disciplinare di gara Prot. U03122001339, indetta a seguito della deliberazione del Consiglio Direttivo Federale nr.86 del 22 Ottobre 2020.

Sono presenti i componenti della detta Commissione Giudicatrice (di seguito Commissione), all'uopo costituita: Dott. Francesco Leonelli, con funzione di Presidente, Dott.ssa Michela Pulici, con funzione di Commissario, e Sig.ra Simonetta Di Bonifacio, con funzione di Commissario. È presente, inoltre, la Dott.ssa Giulia Magni, con funzione di segretaria verbalizzante.

Presente, altresì, in videoconferenza il Dott. Maurizio Galdi, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento.

La Commissione prende atto che della presente seduta è stato dato avviso, oltreché con apposita comunicazione sul sito internet della FMSI, anche a mezzo PEC alle ditte risultate ammesse al prosieguo delle operazioni di gara:

- . Berlinger Special AG;
- . LockCon AG;
- . Versapak International Lt.

La Commissione prende atto inoltre che, come richiesto dalla normativa applicabile, il verbale della seduta del 28 Gennaio u.s., concernente le ammissioni/esclusioni alla procedura in questione, è stato pubblicato su apposita pagina del sito web della FMSI a far data dal 28 Gennaio stesso e che non sono pervenute impugnazioni.

La Commissione, attesa l'aggiudicazione della presente procedura secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ricorda i criteri di valutazione prescritti dall'art.6.1.2 del Disciplinare di gara e dall'art.4 del relativo Capitolato tecnico.

Ciò premesso e già acclarata nel corso della seduta del 28 Gennaio u.s. la conformità alle regole di gara delle offerte presentate dalle Ditte ammesse alla Procedura di Gara per quanto attiene alle modalità di invio e di produzione dei documenti, la Commissione procede alla verifica della documentazione presente nel file "B – Offerta Tecnica" presentata dalla ditta Berlinger, al fine di prendere atto del relativo contenuto e di appurare l'effettiva compatibilità del medesimo con quanto richiesto dal Disciplinare di gara e al relativo Capitolato tecnico.



Vi si rinviene una relazione tecnica scritta in lingua inglese e firmata digitalmente, contenente: profilo e organigramma della Società; elenco delle principali manifestazioni sportive, tra cui tutte le edizioni dei giochi olimpici dal 2000 al 2020, in cui sono stati utilizzati i BEREG kit; elenco dei principali clienti, tra cui i Comitati Olimpici e le più importanti NADO; copia delle certificazioni ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 17025:2017 in corso di validità; portfolio dei prodotti, senza un idoneo corredo fotografico che consenta di acclarare agevolmente il soddisfacimento dei requisiti prescritti dal Disciplinare di gara e dal relativo Capitolato tecnico; dichiarazioni di conformità dei prodotti inerenti alla presente procedura rese, nondimeno, dalla ditta stessa circa il rispetto degli standard imposti dalla normativa di settore (nдр: WADA ISTI e IATA) e dalle certificazioni di qualità (nдр: ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015); iscrizione al registro commerciale; copia di precedenti contratti di fornitura, con dettaglio dei prodotti e relative specifiche tecniche; la certificazione del riconoscimento "Export Award 2020".

Indi, la Commissione procede, in seduta riservata, all'attribuzione dei relativi punteggi nel rispetto dello schema di cui al Capitolato tecnico.

La documentazione relativa all'offerta tecnica presentata dalla ditta Berlinger Special AG viene stampata, siglata in ogni foglio dai membri della Commissione e inserita all'interno di una busta che, a sua volta, viene chiusa e siglata dai membri della Commissione e rimessa agli Uffici per la custodia.

La Commissione successivamente procede, in seduta pubblica, alla verifica della documentazione presente nel file "B – Offerta Tecnica" presentata dalla ditta LockCon AG, al fine di prendere atto del relativo contenuto e di appurare l'effettiva compatibilità del medesimo con quanto richiesto dal Disciplinare di gara e al relativo Capitolato tecnico.


Vi si rinviene una relazione tecnica scritta in lingua italiana contenente: profilo, organigramma ed esperienza pregressa della Società, ancorché con generica elencazione del portfolio clienti; dettagliata descrizione del portfolio prodotti, sia a livello di materiale scelto per la produzione, la cui leggerezza comporta minori costi di stoccaggio e trasporto, sia a livello di standard qualitativi, a garanzia della sicurezza e dell'integrità del contenuto; particolareggiato corredo fotografico, che consente di acclarare agevolmente il soddisfacimento dei requisiti prescritti dal Disciplinare di gara e dal relativo Capitolato tecnico, nonché la convenienza del pre-assemblaggio degli accessori componenti i kit; copia della certificazione ISO 9001:2015 in corso di validità; certificazione di conformità resa dalla Società indipendente LGC circa il rispetto degli standard imposti dalla normativa di settore (nдр: WADA ISTI); copia della polizza assicurativa.

Indi, la Commissione procede, in seduta riservata, all'attribuzione dei relativi punteggi nel rispetto dello schema di cui al Capitolato tecnico.

La documentazione relativa all'offerta tecnica presentata dalla ditta LockCon AG viene stampata, siglata in ogni foglio dai membri della Commissione e inserita all'interno di una busta che, a sua volta, viene chiusa e siglata dai membri della Commissione e rimessa agli Uffici per la custodia.

La Commissione successivamente procede, in seduta pubblica, alla verifica della documentazione presente nel file "B – Offerta Tecnica" presentata dalla ditta Versapak International Lt, al fine di prendere atto del relativo contenuto e di appurare l'effettiva compatibilità del medesimo con quanto richiesto dal Disciplinare di gara e al relativo Capitolato tecnico.

Vi si rinviene una relazione tecnica scritta in lingua inglese e firmata digitalmente, contenente: certificato di iscrizione nel registro inglese; copia della certificazione ISO 9001:2015 in corso di validità; presentazione della società (mission, organigramma); descrizione degli ambiti di business; referenze di clienti, tra cui varie NADO internazionali, ancorché non preminenti, e il Comitato olimpico messicano; descrizione dei processi produttivi; portfolio dei prodotti, con dettaglio delle rispettive specifiche tecniche e corredo fotografico, ancorché in bassa risoluzione.

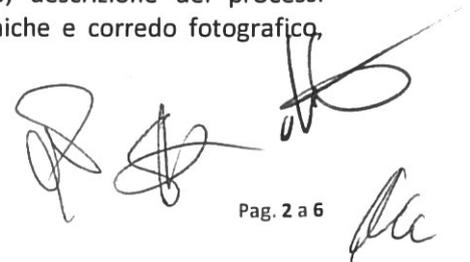

Pag. 2 a 6

Indi, la Commissione procede, in seduta riservata, all'attribuzione dei relativi punteggi nel rispetto dello schema di cui al Capitolato tecnico.

La documentazione relativa all'offerta tecnica presentata dalla ditta Versapak International Lt viene stampata, siglata in ogni foglio dai membri della Commissione e inserita all'interno di una busta che, a sua volta, viene chiusa e siglata dai membri della Commissione e rimessa agli Uffici per la custodia.

Completato l'esame delle offerte tecniche delle Ditte ammesse, la Commissione procede nuovamente in seduta pubblica dando lettura dei punteggi assegnati e delle relative valutazioni compiute, così come sintetizzato nella sottostante tabella:

DITTA	PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA
Berlinger Special AG	46
LockCon AG	55
Versapak International Ltd	42

La Commissione manda agli Uffici per l'inoltro ai competenti organi deliberativi, nonché ai fini delle comunicazioni di rito nei confronti delle parti coinvolte.

Le operazioni di gara sono aggiornate alla seduta del prossimo martedì 9 febbraio.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale scritto in pagine 3, unitamente agli allegati, che viene firmato dal Presidente e dai Commissari.

Dott. Francesco Leonelli




Dott.ssa Michela Pulici



Sig.ra Simonetta Di Bonifacio



Dott. Maurizio Galdi, RUP

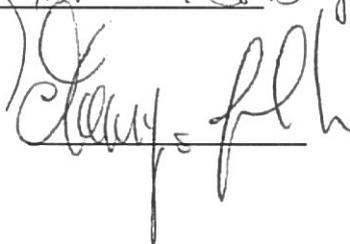

**PROCEDURA SELETTIVA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
MATERIALE TECNICO FUNZIONALE ALLA RACCOLTA DEI CAMPIONI BIOLOGICI (URINE E/O SANGUE)
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA DI BERLINGER SPECIAL AG _ Allegato 1**

VALUTAZIONE DEL PRODOTTO > KIT ANTIDOPING PER PRELIEVI URINARI E/O EMATICI	
Requisiti minimi inderogabili	Presenza/assenza
Sistema di sigillatura che evidenzi traccia di eventuale manomissione	SI
Sistema di numerazione univoco integrato, tramite sistema di codice a barra o data code, conforme ai requisiti operativi di ADAMS che garantisca l’anonimato dell’atleta	SI
Materiale atto ad assicurare l’integrità (caratteristiche chimico-fisiche) dei campioni biologici	SI
Materiale trasparente o comunque atto a consentire l’effettuazione di un check visivo del contenuto	SI
Materiale capace di resistere alle condizioni di utilizzo (i.e. trasporto, analisi e stoccaggio) con elevata capacità di resistenza alle rotture e alla temperatura di stoccaggio	SI
Possibilità di risigillatura	SI
Requisiti soggetti a valutazione discrezionale	Punteggio attribuito
Codice di numerazione univoco in due diverse posizioni	10
Ottimizzazione delle dimensioni in rapporto al contenuto specifico	6
Disponibilità di etichette adesive supplementari (≥4) con codice univoco a barra	4
VALUTAZIONE DEL PRODOTTO > KIT ANTIDOPING PER PRELIEVI URINARI	
Requisiti minimi inderogabili	Presenza/assenza
Limite minimo di volume ≥ 85mL	SI
Requisiti soggetti a valutazione discrezionale	Punteggio attribuito
Presenza di marcature che indichino volumi minimo e massimo	7
Imballaggio a misura a protezione dei contenitori – cfr. norme UN3373 – Categoria B	6
VALUTAZIONE DEL PRODOTTO > KIT ANTIDOPING PER PRELIEVI EMATICI	
Requisiti minimi inderogabili	Presenza/assenza
Capacità minima ≥ 3mL con presenza di anticoagulante EDTA per i prelievi di plasma	SI
Capacità minima ≥ 5mL con presenza di gel di polimeri inerti per i prelievi di siero	SI
Requisiti soggetti a valutazione discrezionale	Punteggio attribuito
Presenza di set igienico (guanti monouso, disinfettante, cerotto)	3
VALUTAZIONE DEL PRODOTTO > BICCHIERI DI RACCOLTA PER URINE	
Requisiti minimi inderogabili	Presenza/assenza
Presenza di una scala graduata da 10 mL a 180 mL	SI
Requisiti soggetti a valutazione discrezionale	Punteggio attribuito
Marcatura a 90 ml	5
Confezione individuale sigillata	5
PUNTEGGIO TOTALE	46

Francesco Leonelli

Simonetta Di Bonifacio

Michela Pulici

**PROCEDURA SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
MATERIALE TECNICO FUNZIONALE ALLA RACCOLTA DEI CAMPIONI BIOLOGICI (URINE E/O SANGUE)
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA DI LOCKCON AG _ Allegato 2**

VALUTAZIONE DEL PRODOTTO > KIT ANTIDOPING PER PRELIEVI URINARI E/O EMATICI	
Requisiti minimi inderogabili	Presenza/assenza
Sistema di sigillatura che evidenzi traccia di eventuale manomissione	SI
Sistema di numerazione univoco integrato, tramite sistema di codice a barra o data code, conforme ai requisiti operativi di ADAMS che garantisca l'anonimato dell'atleta	SI
Materiale atto ad assicurare l'integrità (caratteristiche chimico-fisiche) dei campioni biologici	SI
Materiale trasparente o comunque atto a consentire l'effettuazione di un check visivo del contenuto	SI
Materiale capace di resistere alle condizioni di utilizzo (i.e. trasporto, analisi e stoccaggio) con elevata capacità di resistenza alle rotture e alla temperatura di stoccaggio	SI
Possibilità di risigillatura	SI
Requisiti soggetti a valutazione discrezionale	Punteggio attribuito
Codice di numerazione univoco in due diverse posizioni	10
Ottimizzazione delle dimensioni in rapporto al contenuto specifico	10
Disponibilità di etichette adesive supplementari (≥4) con codice univoco a barra	4
VALUTAZIONE DEL PRODOTTO > KIT ANTIDOPING PER PRELIEVI URINARI	
Requisiti minimi inderogabili	Presenza/assenza
Limite minimo di volume ≥ 85mL	SI
Requisiti soggetti a valutazione discrezionale	Punteggio attribuito
Presenza di marcature che indichino volumi minimo e massimo	7
Imballaggio a misura a protezione dei contenitori – cfr. norme UN3373 – Categoria B	10
VALUTAZIONE DEL PRODOTTO > KIT ANTIDOPING PER PRELIEVI EMATICI	
Requisiti minimi inderogabili	Presenza/assenza
Capacità minima ≥ 3mL con presenza di anticoagulante EDTA per i prelievi di plasma	SI
Capacità minima ≥ 5mL con presenza di gel di polimeri inerti per i prelievi di siero	SI
Requisiti soggetti a valutazione discrezionale	Punteggio attribuito
Presenza di set igienico (guanti monouso, disinfettante, cerotto)	4
VALUTAZIONE DEL PRODOTTO > BICCHIERI DI RACCOLTA PER URINE	
Requisiti minimi inderogabili	Presenza/assenza
Presenza di una scala graduata da 10 mL a 180 mL	SI
Requisiti soggetti a valutazione discrezionale	Punteggio attribuito
Marcatura a 90 ml	5
Confezione individuale sigillata	5
PUNTEGGIO TOTALE	55

Francesco Leonelli

Simonetta Di Bonifacio

Michela Pulici

**PROCEDURA SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
MATERIALE TECNICO FUNZIONALE ALLA RACCOLTA DEI CAMPIONI BIOLOGICI (URINE E/O SANGUE)
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA DI VERSAPAK INTERNATIONAL LT_ Allegato 3**

VALUTAZIONE DEL PRODOTTO > KIT ANTIDOPING PER PRELIEVI URINARI E/O EMATICI	
Requisiti minimi inderogabili	Presenza/assenza
Sistema di sigillatura che evidenzi traccia di eventuale manomissione	SI
Sistema di numerazione univoco integrato, tramite sistema di codice a barra o data code, conforme ai requisiti operativi di ADAMS che garantisca l'anonimato dell'atleta	SI
Materiale atto ad assicurare l'integrità (caratteristiche chimico-fisiche) dei campioni biologici	SI
Materiale trasparente o comunque atto a consentire l'effettuazione di un check visivo del contenuto	SI
Materiale capace di resistere alle condizioni di utilizzo (i.e. trasporto, analisi e stoccaggio) con elevata capacità di resistenza alle rotture e alla temperatura di stoccaggio	SI
Possibilità di risigillatura	SI
Requisiti soggetti a valutazione discrezionale	Punteggio attribuito
Codice di numerazione univoco in due diverse posizioni	10
Ottimizzazione delle dimensioni in rapporto al contenuto specifico	1
Disponibilità di etichette adesive supplementari (≥4) con codice univoco a barra	4
VALUTAZIONE DEL PRODOTTO > KIT ANTIDOPING PER PRELIEVI URINARI	
Requisiti minimi inderogabili	Presenza/assenza
Limite minimo di volume ≥ 85mL	SI
Requisiti soggetti a valutazione discrezionale	Punteggio attribuito
Presenza di marcature che indichino volumi minimo e massimo	7
Imballaggio a misura a protezione dei contenitori – cfr. norme UN3373 – Categoria B	7
VALUTAZIONE DEL PRODOTTO > KIT ANTIDOPING PER PRELIEVI EMATICI	
Requisiti minimi inderogabili	Presenza/assenza
Capacità minima ≥ 3mL con presenza di anticoagulante EDTA per i prelievi di plasma	SI
Capacità minima ≥ 5mL con presenza di gel di polimeri inerti per i prelievi di siero	SI
Requisiti soggetti a valutazione discrezionale	Punteggio attribuito
Presenza di set igienico (guanti monouso, disinfettante, cerotto)	3
VALUTAZIONE DEL PRODOTTO > BICCHIERI DI RACCOLTA PER URINE	
Requisiti minimi inderogabili	Presenza/assenza
Presenza di una scala graduata da 10 mL a 180 mL	NO (fino a 150mL, cmq sufficiente)
Requisiti soggetti a valutazione discrezionale	Punteggio attribuito
Marcatura a 90 ml	5
Confezione individuale sigillata	5
PUNTEGGIO TOTALE	42

Francesco Leonelli

Simonetta Di Bonifacio

Michela Pulici